




### DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

DECRETO N° 316

DEL 06/07/2022

**OGGETTO** Riconoscimento ora per allora, dell’Affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 co.2 lettera a) del D.lgs. 50/2016, così come modificato dall’art. 51 D.L 77/2021 convertito dalla L. n. 108/2021, alla ditta Thermo Fisher per l’eseguito intervento, in urgenza, di manutenzione per guasto dell’autocampionatore TRIPLUIS AS - S/N 20083988, a servizio del GC -FID Trace GC Ultra S/N 320080397 in uso presso la UOC lab CT dell’Agenzia ARPA Sicilia, per un importo a consuntivo pari a € 7.904,00 IVA esclusa;


**SMART CIG : Z3A36DD558**

<p>Su richiesta del Direttore UOC LAB CT Cod. Serv. DIP LAB-UOC LAB CT- UOC CT Cod. centro di costo _2-0401ALL100</p> <p><b>PROPOSTA di Decreto n.146 del 06/06/2022</b></p> <p><b>RUP DEL PROCEDIMENTO</b> <b>Il Direttore UOC L 1. CT</b> <b>Dott. Daniele Parlascino</b> </p> <p>Estensore Il coll. Tecn. Ing. Giovanna Mirabile </p> <p>IL DIRETTORE UOC A3 Ing. Giuseppe Lo Iacono </p>	<p>U.O.C. A2 GESTIONE RISORSE ECONOMICHE</p> <p>Autorizzazione spesa del <u>30/6/2022</u></p> <p><input type="checkbox"/> <b>Conto Economico</b> __ conto cod. 23.02.04 "Manutenzione attrezzature scientifiche"</p> <p>Importo imponibile € 7.904,00 Importo per iva € 1.738,88 <b>spesa complessiva € 9.642,88</b></p> <p><input type="checkbox"/> Conto Patrimoniale _____ Importo _____</p> <p><input type="checkbox"/> Non comporta oneri di spesa</p> <p>Visto in quanto conforme alle norme di contabilità economico patrimoniale</p> <p>IL DIRETTORE DELL'UOC A2 Dott. Antonio Guzzardi </p>
---	---

In data 06/07/2022 nella sede legale dell'ARPA in Palermo, viale Cristoforo Colombo, Complesso Roosevelt, località Addaura - P.I. 05086340824

**IL DIRETTORE GENERALE - Dr. Vincenzo Infantino**

nominato con Decreto dell'Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente n. 37/GAB del 4 Marzo 2021, come modificato dal DA n.70 del 30/04/2021 assistito dal segretario Umberto Vizzini adotta il seguente decreto sulla base della proposta di seguito riportata.

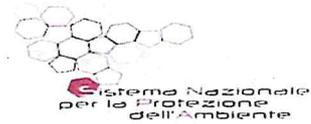

## PROPOSTA DI DECRETO DEL DIRETTORE di sede CT ARPA Sicilia

N°146 DEL 06/06/2022

**OGGETTO:** Riconoscimento ora per allora, dell'Affidamento diretto, ai sensi dell'art.36 co.2 lettera a) del D.lgs. 50/2016, così come modificato dall'art. 51 D.L 77/2021 convertito dalla L. n. 108/2021, alla ditta Thermo Fisher per l'eseguito intervento, in urgenza, di manutenzione per guasto dell'autocampionatore TRIPLUIS AS - S/N 20083988, a servizio del GC -FID Trace GC Ultra S/N 320080397 in uso presso la UOC lab CT dell'Agenzia ARPA Sicilia, per un importo a consuntivo pari a € 7.904,00 IVA esclusa;

**SMART CIG : Z3A36DD558**

**Il Direttore di sede CT ARPA Sicilia**

### Premesso che

ARPA Sicilia ha la necessità di garantire la piena efficienza dei Laboratori di analisi sia in ordine ai compiti istituzionali da adempiere che in ordine alla collaborazione con le autorità di vigilanza;

Il Laboratorio della UOC Lab CT dell'Agenzia ha accreditato prove di determinazione che occorre eseguire con il sistema analitico \_\_\_autocampionatore TRIPLUIS AS - S/N 20083988, \_ GC -FID Trace GC Ultra S/N 320080397 ;


La UOC Lab CT , ha, a suo tempo, inviato alla UOC A3 la nota prot. 42853/2021 del 27/08/2021 con evidenza di richiesta di avvio della procedura di affidamento diretto del servizio di manutenzione per guasto dell'autocampionatore TRIPLUIS AS - S/N 20083988, a servizio del GC -FID Trace GC Ultra S/N 320080397 in uso presso la UOC lab CT, alla ditta Thermo Fisher, come da offerta acquisita n. 21594404 del 23/07/2021 di importo pari a € 7.818,00;

La UOC A3 circa l'intervento tecnico prima descritto, ha indetto con DDG 391 del 15/09/2021 \_ CIG\_ 2433309140 procedura a contrarre, ai sensi dell'art.36 co.2 lettera a) del D.lgs. 50/2016, così come modificato dall'art. 51 D.L 77/2021 convertito dalla L. n. 108/2021, che è stata esperita a mezzo ODA su Mepa con unico operatore ditta Thermo Fisher, e il cui esito è stato di procedura deserta;

In considerazione dell'esito di procedura deserta l'intervento di che trattasi è stato inserito nella procedura a contrarre dedita a tutte le apparecchiature Thermo Fisher presenti nei laboratori ARPA Sicilia\_ DDG 104 del 21 marzo 2022\_ "Manutenzione correttiva per guasto dedita a n. 5 sistemi analitici marca Thermo Fisher e Manutenzione preventiva ordinaria annuale dedita a n.17 sistemi analitici di marca Thermo Fisher, in uso presso le UOC Laboratorio ARPA Sicilia, indetta ai sensi dell'art.36 co.2 lettera a) del D.lgs. 50/2016, così come modificato dall'art. 51 D.L 77/2021 convertito dalla L. n. 108/2021, che è stata esperita a mezzo RDO MEPA N. 2982833 aperta, e il cui esito anche in questo caso è stato di procedura deserta;

Sono state assunte notizie presso la ditta Thermo Fisher, ditta costruttrice del sistema analitico e riferimento essenziale circa l'acquisto di ricambi originali e performance tecnica di assistenza tecnica, circa le difficoltà momentanee a esitare le richieste amministrativi a mezzo piattaforme informatiche (MEPA\_ Piattaforma Appalti ARPA), a seguito del trasferimento della sede Direzionale della ditta presso altra Nazione, Bulgaria;

**CONSIDERATE** le ragioni di somma urgenza in ordine ai compiti istituzionali da adempiere circa le attività laboratoriste condotte anche per ragioni di collaborazione con le autorità di vigilanza;

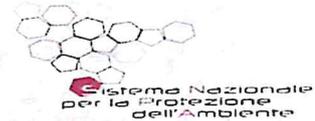

**VISTO** l'allora acquisita offerta tecnica n. 21594404 del 23/07/2021 di importo presunto pari a € 7.818,00 formulata dalla ditta Thermo Fisher, circa l'intervento tecnico da eseguire per la risoluzione del guasto dell'autocampionatore TRIPLUIS AS - S/N 20083988, a servizio del GC -FID Trace GC Ultra S/N 320080397 in uso presso la UOC lab CT, di importo pari a € 7.818,00 salvo ulteriori costi per manodopera e ricambi non preventivabili;

**RITENUTO** in ordine alla prestazione del servizio di che trattasi, congrua la suddetta offerta presentata dalla ditta Thermo Fisher, pari a € 7.818,00 IVA esclusa salvo ulteriori costi per manodopera e ricambi non preventivabili;

**RITENUTO** opportuno,

\_ per ragioni di somma urgenza, di disporre nei confronti della ditta Thermo Fischer ordine di intervento immediato all'esecuzione del servizio di manutenzione per guasto dell'autocampionatore TRIPLUIS AS - S/N 20083988, a servizio del GC -FID Trace GC Ultra S/N 320080397 in uso presso la UOC lab CT;

\_ di avvalersi delle procedure di riconoscimento del preciso ammontare dell'affidamento in esito alle risultanze a consuntivo dell'intervento eseguito dalla ditta;

\_ in relazione alla specifica del bene e alla modesta entità di spesa, comunque inferiore alla soglia di € 40.000,00, di procedere *ai sensi dell'articolo 1, comma 2 lettera a) del decreto legge n. 76/2020 (l. 120/2020) così come modificato dall'art. 51 del d.l. n.77 del 31/05/2021* ad affidare ora per allora, alla ditta Thermo Fisher, l'intervento di che trattasi;

**VISTO** il consuntivo trasmesso dalla ditta e assunto al prot. ARPA Sicilia al n. 0026055/2022 del 18/05/2022

Diritto di chiamata Zona 3 + 3h manodop.	1.504,00 EUR
Manodopera successiva alla 3a ora -	726,00 EUR
Sostituzione MFS_XY MOTOR DRIVER BOARD 1	708,00 EUR
ASSY TRIPLUS AS TURRET *L 1	4.880,00 EUR
SYRINGE 10UL X 50MM NEEDLE CONE	86,00 EUR
<b>Subtotale</b>	<b>7.904,00 EUR</b>

di cui si attesta la regolarità tecnica dell'eseguito;

**RITENUTO** congruo il consuntivo presentato dalla ditta Thermo Fisher, pari a **7.904,00 EUR** IVA esclusa;

**VISTO** la regolarità del DURC della ditta prot. INAIL \_29718820 con validità al 06/06/2021;

**PRECISATO** che la spesa di cui sopra compete *al conto cod. 01.02.24 "Manutenzione attrezzature scientifiche"* del Bilancio Economico 2022 dell'Agenzia;

**VISTO** il DDG 490 del 29/10/2021 di Adozione del Bilancio Economico pluriennale 2022-2024;

**PRECISATO** che la spesa di cui sopra compete al conto cod. conto cod. 16.01.41 "Materiale tecnico-sanitario da laboratorio del Bilancio Economico 2022 dell'Agenzia;

**VISTO**

- ~ l'art. 90 della legge Regionale 03.05.01 n. 6 [Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - ARPA-Sicilia];
- ~ la L.R. n.4 del 16/04/2003 e in particolare l'art. 94 di integrazione e modifiche all'art. 90 della L. 6/2001;
- ~ la L. n.132 del 28/06/2016 e in particolare l'art. 3" Funzioni del Sistema Nazionale" e art. 7" Agenzie per la protezione dell'ambiente";

- ~ Il D.A. n. 239/GAB del 31/05/2019 (pubblici. in GURS parte I n. 31 del 05/07/2019) di approvazione del "Regolamento di organizzazione e Funzionamento dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente ARPA Sicilia" adottato con DDG. n 192 del 30/04/2019 dal Direttore Generale di ARPA Sicilia;
- ~ Il DDG n. 361 del 05/07/2019 "Preso atto Adozione del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente \_ ARPA Sicilia ex art. 90 L.6/"001;
- ~ Il DDG n. 420 del 27/08/2019 "Adozione dell'articolazione e Funzioni gramma di Arpa Sicilia";
- ~ Il DDG n. 437 del 06/09/2019 di rettifica al DDG n. 420 del 27/08/2019;
- ~ gli articoli 5 e 6 della Legge 241/1990 e s.m.i. in merito alla responsabilità del procedimento amministrativo;
- ~ il decreto del Presidente del Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nella parte ad oggi applicabile al procedimento in questione;
- ~ l'art.31 del D.Lgs. n. 50 del 2016 ss.mm.ii. Codice Appalti;
- ~ le prescrizioni contenute nelle Linee Guida n.3 "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per affidamenti di appalti e concessioni", emanate dall'ANAC con determinazione n.1096 del 26 ottobre 2016, e il Comunicato del Presidente del 14 dicembre 2016;
- ~ la legge 13 agosto 2010, n.136 e, in particolare, l'art.3 a proposito della disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- ~ il Piano Triennale di prevenzione della corruzione di ARPA Sicilia (2022/2024);
- ~ il Programma triennale Trasparenza e Integrità di ARPA Sicilia (2022/2024);

**VISTO** il DDG 237 del 17.06.2021 recante "Adozione del regolamento inerente la responsabilità e funzioni dei soggetti che intervengono nel processo di acquisizione di beni e servizi in Arpa Sicilia" in cui si conferma che il RUP ex art. 31 del D.Lgs. n.50/2016 è individuato, di norma, nell'ambito della struttura competente per materia e/o richiedente l'acquisto del bene/servizio;

**DICHIARATA** ai sensi della normativa vigente, dal Direttore della U.O.C Lab. CT, dottore Daniele Parlascino l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, e l'assenza di cause di incompatibilità a svolgere l'incarico di RUP del provvedimento;

**PRESO ATTO** della regolarità dell'istruttoria della relativa pratica e della conformità della presente proposta alla normativa vigente che disciplina la materia trattata;

#### PROPONE


Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono tutti integralmente ripetuti e trascritti di:

1. **Affidare** ora per allora, ai sensi dell'art.36 co.2 lettera a) del D.lgs. 50/2016, così come modificato dall'art. 51 D.L 77/2021 convertito dalla L. n. 108/2021, alla ditta Thermo Fisher l'eseguito intervento, in urgenza, di manutenzione per guasto dell'autocampionatore TRIPLUIS AS - S/N 20083988, a servizio del GC -FID Trace GC Ultra S/N 320080397 in uso presso la UOC lab CT dell'Agenzia ARPA Sicilia, per un importo a consuntivo pari a € 7.904,00 IVA esclusa;
2. **Imputare** l'onere economico pari a € 9.642,88 di cui € 7.904,00 per imponibile e € 1.738,88 per IVA al 22% sul conto cod. 23.02.04 "Manutenzione attrezzature scientifiche" del Bilancio Economico 2022 dell'Agenzia.
3. **Autorizzare** la UOC A2 ad emettere apposito mandato di pagamento in favore della Ditta, a presentazione di fattura, dopo avere acquisito la documentazione a corredo da parte dell'Ufficio UOC A3 di ARPA Sicilia, previa verifica di conformità e attestazione di regolare fornitura da parte del RUP.

Il RUP \_Direttore di sede CT ARPA Sicilia

Dott. Daniele Parlascino



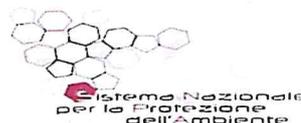

**Sul presente atto viene espresso**

Parere favorevole del Direttore Amministrativo

Dott. Pietro Maria Testai

**IL DIRETTORE GENERALE**


- Vista la proposta di decreto che precede e che qui si intende riportata e trascritta;
- Preso atto del parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo;
- Ritenuto di condividerne i contenuti;
- Assistito dal segretario verbalizzante;

**DECRETA**

APPROVARE la superiore proposta di Decreto così come formulata dal Dirigente Responsabile della UOC proponente dando mandato al Responsabile dell'Ufficio Decreti del Direttore Generale di predisporre gli adempimenti conseguenti l'adozione del presente Decreto.

**Il Direttore Generale**  
**Dr. Vincenzo Infantino**

Il segretario verbalizzante

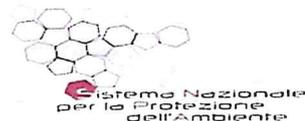

Notificato al Collegio dei Revisori per il preventivo parere ai sensi dell'art. 7, comma 7 del Regolamento di Organizzazione di ARPA (approvato con D.A. n. 239/GAB del 31/05/2019)  
 con nota prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_  
 di Organizzazione di ARPA (approvato con D.A. n. 239/GAB del 31/05/2019)  
 con nota prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_

**PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto dichiara che il presente decreto, copia conforme all'originale, è stato pubblicato all'Albo dell'ARPA, per gli effetti dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18 giugno 2009 e dell'art. 1 del D. Lgs. n. 33/2013 a decorrere dal 07/07/2021 e fino al \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_

L'incaricato della pubblicazione  
 \_\_\_\_\_

ESTREMI RISCONTRO TUTORIO	
<input checked="" type="checkbox"/> Decreto <b>IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO</b>  <input type="checkbox"/> Decreto <b>ESECUTIVO</b>	Decreto trasmesso all'Assessorato Territorio e Ambiente in data ___/___/_____ Prot. n. _____  <p style="text-align: center;"><b>SI ATTESTA</b></p> Che l'Assessorato Territorio e Ambiente esaminato il presente decreto  <input type="checkbox"/> ha pronunciato l'approvazione con atto prot. n. _____ del ___/___/_____  <input type="checkbox"/> ha pronunciato l'annullamento con atto prot. n. _____ del ___/___/_____  <p style="text-align: center;"><b>SI ATTESTA</b></p> <input type="checkbox"/> il Decreto si intende approvato.

L'incaricato dell'Ufficio Decreti del Direttore Generale